

SCHWILLE - ELEKTRONIK
Produktions- und Vertriebs GmbH
Benzstrasse 1 A
85551 Kirchheim/ Germany

EMV Prüfbericht EMC Testreport



Gegenstand Equipment (EUT) Sensorbox

Hersteller Manufacturer SEIKA Mikrosystemtechnik GmbH, 87435 Kempten

Typ Type

SBL1

Serien Nr. Serial Number 927

Auftraggeber Customer SEIKA Mikrosystemtechnik GmbH, 87435 Kempten

Prüfziel Test Target DIN EN 61326, Ausgabe:2002-03 Elektrische Betriebsmittel für Meßtechnik,

Leittechnik und Laboreinsatz - EMV-Anforderungen (IEC 61326-1:1997+ A1:1998+A2:2001)

Prüfergebnis Prüfungen erfüllt. Test Result Test passed.

Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge und Änderungen bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Laboratoriums. Prüfberichte ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand.

This test report may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory. Test reports without signature and seal are not valid. This test report applies to the tested object only.

Stempel Datum Seal Date

Leiter des Laboratoriums
Head of the laboratory

Schwille-Elektronik Produktions- und Vertriebs GmbH

Benzstraße 1 A, 85551 Kirchheim 2.7.2002

A. i. Manfred Schiedrich



Allgemeine Daten Project Information

Ansprechpartner des Auftraggebers

Test Manager - Customer

Herr Schmidt

Eingang der Prüfmuster

Date of Receipt of Equipment Under Test

25.6.2002

Durchführung der Prüfung

Date of Measurement

25.6.2002

Zustand des Prüfmusters

Condition of Equipment Under Test (EUT)

Neuwertig/New

Kundenteilnehmer während der Prüfung Customer Manager Present during Test Herr Schmidt

Verantwortlich für die Durchführung

Test Manager Laboratory

Herr Schiedrich

Verantwortlich für den Prüfbericht Compilation of Test Report by

Herr Schiedrich

Umgebungsbedingungen Environment

Temperatur Temperature 23 °C

Meßmedium Cleanliness

normal bewegte Luft Visibility Clean Ambient

Luftdruck

Atmospheric Pressure

946 hPa

Luftfeuchte Relative Humidity 34 %



Beschreibung des Prüfgegenstandes gemäß Kundenangaben Description of the Equipment Under Test (EUT)

Betriebsspannung Supply Voltage

12 V DC

Anschlußleitung

Bonding

mehradrig

Art der Erdung **Ground Bonding** Keine None

Größe des Prüflings

Dimension EUT

HxBxT18 cm x 18 cm x 10 cm

 $H \times W \times D$

Tischgerät/ Table Top Equipment

Betriebsart Performance Die Sensorbox wird an Spannung geschlossen. Der zur Winkellage proportionale

Ausgangsstrom wird mit einem Multimeter überwacht.

Betriebszustand Applicability

In Betrieb In Use

Beschreibung der Bewertungskriterien Description of Failure Abweichung der Ausgangssignale.

Output signal changes.

Zusatzgeräte und Leitungen

Connection Parts

and Cable

Datenleitung, ungeschirmt/ unshielded, 15 m Länge/ Length

Interne Störquellen **CPU** Internal Radiated Source

Filter/ Schirmung Filter/ Shielding

Metallgehäuse Metal Case



Inhaltsverzeichnis Index

Messungen und Prüfungen akkreditiert von DATech e.V. unter DAR-Registrierungsnummer TTI-P-G115/96-01:	Ergebnis <i>Result</i>	Seite Page
Prüfung der Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladungen (ESD)	Test bestanden	5
Susceptibility Against Electrostatic Discharge - Air Discharge (ESD)	Test passed	5
Prüfung der Störfestigkeit gegen hochfrequente Einstrahlung	Test bestanden	12
Susceptibility Against Radiated Fields	Test passed	12
Prüfung der Störfestigkeit gegen transiente Störsignale (BURST)	Test bestanden	16
Susceptibility Against ns-Pulses (BURST)	Test passed	16
Prüfung der Störfestigkeit gegen hochfrequente Einströmung	Test bestanden	19
Susceptibility Against Conducted Sinus Wave	Test passed	19
Messung der Funkstörspannung	Test bestanden	22
Measuring Conducted Voltage Emission	Test passed	22
Messungen und Prüfungen im nicht akkreditierten Bereich:		
Messung der elektrischen Funkstörfeldstärke	Test bestanden	29
Measuring Radiated E-Field Emission	Test passed	29



Prüfung der Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladungen (ESD) Susceptibility Against Electrostatic Discharge - Air Discharge (ESD)

Test bestanden Test passed

Prüfverfahren/ Test Specification

DIN EN 61000-4-2, Ausgabe:2001-12, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-2: Prüf- und Messverfahren; Prüfung der Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität (IEC 61000-4-2:1995 + A1:1998 + A2:2000); Deutsche Fassung EN 61000-4-2:1995 + A1:1998 + A2:2001

Eingesetzte Meßgeräte/ Test Equipment

Kal./Cal.

Tektronix Oszilloskop/ Oscilloscope	TDS 220	SN.	B 013129	2.2003
Tektronix Tastkopf/ Oscilloscope Probe	P 5100			2.2003


DKD Kalibrierung/ DKD Verification

EM-TEST ESD Generator	ESD	SN. 30	2.2003
EM-TEST Entladepistole 150pF/330 Ohm/Probe	P18		2.2003

Meßunsicherheit Strom/ Calibration Uncertainty Current +- 3 %
Meßunsicherheit Zeit/ Calibration Uncertainty Time +- 0,01 %

Die Kalibrierung ist rückführbar auf nationale Einheiten. The calibration is traceable to national normals.

Interne Kalibrierung des Messaufbaues/ Inhouse Verification of Test Setup



Die Entladepistole wird aufgesetzt und eine Kontaktentladung an dem 2 Ohm/ 48 Ohm Widerstand durchgeführt. The discharge probe is placed on the 2 ohms/ 48 ohms resistor and a contact discharge is triggered. Die Meßkurve wird am Oszilloskop betrachtet. The oscilloscope displays the measured graph.


Angezeigte	Erste Entlade	Anstiegszeit	Strom	Strom
Spannung	Stromspitze		bei 30 ns	bei 60 ns
2 kV +- 5%	7,5A +-10%	0,7 bis 1 ns	4A +-30%	2A +-30%
4 kV +- 5%	15A +-10%	0,7 bis 1 ns	8A +-30%	4A +-30%
6 kV +- 5%	22,5A +-10%	0,7 bis 1 ns	12A +-30%	6A +-30%
8 kV +- 5%	30A +-10%	0,7 bis 1 ns	16A +-30%	8A +-30%

Prüfdurchführung/ Test Operation

Messplatz 2/ Test Site 2 Absorberhalle/ Anechoic Chamber (Foam)



Testaufbau/ Test Setup



Impulse je Prüfpunkt/ *Pulse/ Test point* Wiederholzeit/ *Periode*

10 Impulse/ 10 Pulses 1 Impuls/ Sekunde 1 Puls / Sec.

Das Ziel des Tests ist die Reaktion des Gerätes zu bestimmen, die von Menschen verursacht werden, die z.B. auf einen Kunstfaserteppich gehen. The aim of this test is to determine the reaction of the EUT to electrostatic discharges produced by the personnal for example by walking on a carpet made of synthetic fibre.

Der Erdanschluß wird an die Bezugsmasseplatte angeschlossen. EUT with earth wire connected to the groundplane.

Das Zeitintervall zwischen aufeinanderfolgenden Entladungen wird auf eine Zeitdauer ausgedehnt, die den Abbau der auf den Prüfling aufgebrachten Ladung erlaubt. *The time interval between successive discharges shall be extended to the time necessary to allow decay of the charge from the EUT.*

Die Entladung statischer Elektrizität werden nur an solchen Punkten und Oberflächen des Prüflings ausgeführt, die Bedienpersonal bei üblicher Verwendung zugänglich sind. *The static electricity discharges shall be applied only to those points and surfaces which are accessible to persons during normal use of the intended functions.*

Prüfmerkmale/ Test Passed by Result

Luftentladung/ *Air Discharge* 8 kV, Kontaktentladung/ *Contact Discharge* 4 kV. Bewertungskriterium/ *Performance Criteria B*

Bewertungskriterien für das Betriebsverhalten/ Performance Criteria in Accordance with Description

- A Bestimmungsgemäßes Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. Normal performance within the specification limits.
- B Zeitlich begrenzte Minderung der Funktion oder Funktionsausfall, die das Gerät selbst wieder herstellt. Temporary degradation or loss of function or performance which is self-recoverable
- C Zeitlich begrenzte Minderung der Funktion oder Funktionsausfall, die einen Eingriff der Bedienungsperson oder die Rücksetzung des Systems erfordern. *Temporary degradation or loss of function or performance which requires operator intervention or system reset.*
- D Minderung der Funktion oder Funktionsausfall, die nicht mehr hergestellt werden kann, da das Gerät, die Betriebssoftware zerstört wurden oder Daten verloren gingen. Degradation or loss of function which is not recoverable due to damage of equipment (components) or software, or loss of data.

Das Bewertungskriterium wird überwacht durch Beobachtung. *Performance criteria will be observed by operator.*


Gemessene Anschlüsse/ Measuring Ports

Gehäuse/ Enclosure



Betriebszustand Applicability In Betrieb
In Use

Frontansicht Front View

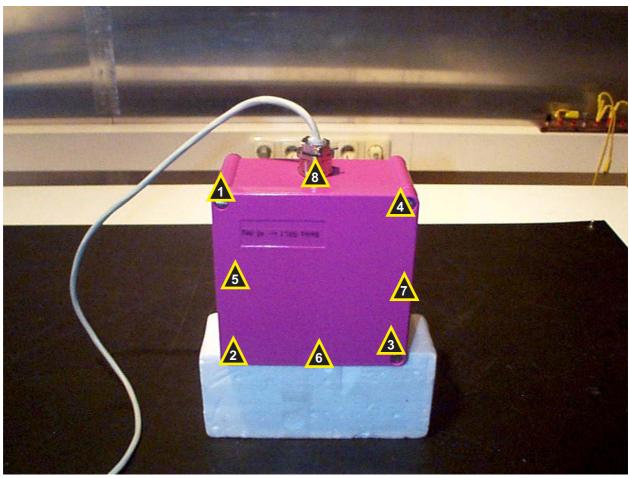

Kontaktentladung Contact discharges Luftentladung Air discharges

Prüfspannung/ *Charge voltage* +2kV +4kV +6kV +8kV

-2kV -4kV -6kV -8kV

+2kV +4kV

+8kV +15kV

-2kV -4kV -8kV -15kV

Entladepunkt/ Charge point

Bewertungskriterium/ Performance Criteria Ausfallzeit/ Failure Time

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
<u> </u>	

8

iki Orlange point	Devi	verturiç	JSKIILGI	iuiii/ i	GHOHH	ance one	ila Ausia	IIZGIU 1	anure	TITTE	
	Α	Α	Α	Α			А	Α	Α	Α	
	Α	Α	Α	Α			А	Α	Α	Α	
	Α	Α	Α	Α			А	Α	Α	Α	
	Α	Α	Α	Α			А	Α	Α	Α	
	Α	Α	Α	Α			А	Α	Α	Α	
	Α	Α	Α	Α			А	Α	Α	Α	
	Α	Α	Α	Α			А	Α	Α	Α	
	Α	Α	Α	Α			А	Α	Α	Α	



Betriebszustand Applicability In Betrieb
In Use

Draufsicht Top View



Kontaktentladung Contact discharges

Luftentladung
Air discharges

Prüfspannung/ Charge voltage +2kV +4kV +6kV +8kV

+2kV +4kV +8kV +15kV

-2kV -4kV -6kV -8kV

-2kV -4kV -8kV -15kV

Entladepunkt/ Charge point


Bewertungskriterium/ Performance Criteria Ausfallzeit/ Failure Time

Emadopama onargo pome	50.		,01111101	101111/	01101111	u1100 01110	,,,a , taola	0.0 /	anaro		
<u></u>	Α	Α	Α	Α			А	Α	Α	Α	
2	Α	Α	Α	А			А	Α	Α	Α	
3	Α	Α	Α	А			А	Α	Α	Α	
<u></u>	Α	Α	Α	Α			А	Α	Α	Α	
<u></u>	Α	Α	Α	А			А	Α	Α	Α	
<u></u>	Α	Α	Α	Α			А	Α	Α	Α	
7	Α	Α		Α			А	Α		Α	
8	Α	Α		Α			А	Α		Α	



Betriebszustand Applicability In Betrieb
In Use

Linke Seite Left View

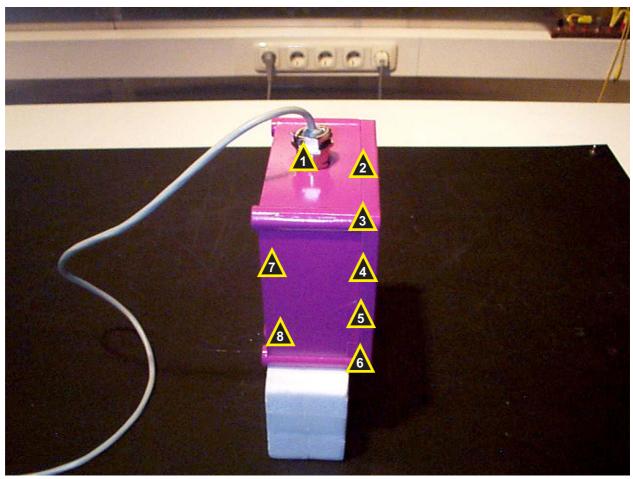

A K

Kontaktentladung Contact discharges Luftentladung Air discharges

Prüfspannung/ *Charge voltage* +2kV +4kV +6kV +8kV

011/ 411/

+2kV +4kV +8kV +15kV

-2kV -4kV -6kV -8kV

-2kV -4kV -8kV -15kV

Entladepunkt/ Charge point

Bewertungskriterium/ Performance Criteria Ausfallzeit/ Failure Time




Α	Α	Α	Α		Α	Α	Α	Α	
Α	Α	Α	Α		Α	Α	Α	А	
Α	Α	Α	Α		А	Α	Α	Α	
Α	Α	Α	Α		А	Α	Α	Α	
Α	Α	Α	Α		А	Α	Α	Α	
Α	Α	Α	Α		Α	Α	Α	Α	
Α	Α	Α	Α		Α	Α	Α	Α	
Α	Α	Α	Α		Α	Α	Α	Α	



Betriebszustand Applicability In Betrieb
In Use

Rückseite Back View

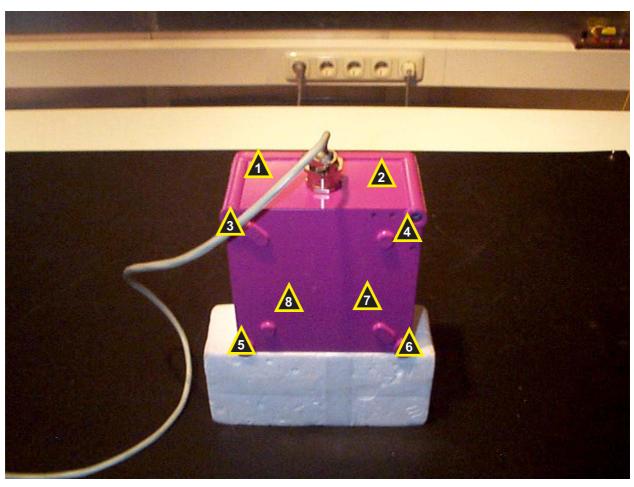

Kontaktentladung Contact discharges Luftentladung Air discharges

Prüfspannung/ Charge voltage

+2kV +4kV +6kV +8kV

+2kV +4kV

+8kV +15kV

-2kV -4kV -6kV -8kV

-2kV -4kV -8kV -15kV

Entladepunkt/ Charge point

Bewertungskriterium/ Performance Criteria Ausfallzeit/ Failure Time



into orion go ponite			,		0	 				
	Α	Α	Α	Α		Α	Α	Α	Α	
	Α	Α	Α	Α		Α	Α	Α	Α	
	Α	Α	Α	Α		Α	Α	Α	Α	
	Α	Α	Α	Α		Α	Α	Α	Α	
	Α	Α	Α	Α		Α	Α	Α	Α	
	Α	Α	Α	Α		Α	Α	Α	Α	
	Α	Α	Α	Α		Α	Α	Α	Α	
	Α	Α	Α	Α		Α	Α	Α	Α	



Prüfdurchführung/ Test operation -	- Betri	ebszu	ıstand	/ Applicability	In Be	etrieb/	In Use	•
Indirekte Entladung auf Koppelplatte Contact Discharge on coupling plate		•	ıng/ <i>Cl</i> V +6k√	narge voltage / +8kV	-2kV	-4kV	-6kV	-8kV
Entladepunkt/ Charge point	Bewe	ertung	skriteri	um/ Performance C	riteria	Ausfall	lzeit/ Fa	ailure Time
Koppelplatte unter Prüfling HCP CP under EUT	Α	Α	Α	А	Α	Α	Α	A
Koppelplatte rechts Prüfling VCP CP rightside EUT	Α	Α	Α	А	Α	Α	Α	A
Koppelplatte vor Prüfling VCP CP before EUT	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	A
Koppelplatte links Prüfling VCP CP leftside EUT	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	A
Koppelplatte hinter Prüfling VCP CP behind EUT	Α	А	A	A	A	A	A	A



Prüfung der Störfestigkeit gegen hochfrequente Einstrahlung Susceptibility Against Radiated Fields

Test bestanden Test passed

Prüfverfahren/ Test Specification


DIN EN 61000-4-3, Ausgabe:2001-12, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-3: Prüf- und Messverfahren; Prüfung der Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder (IEC 61000-4-3:1995 + A1:1998 + A2:2000); Deutsche Fassung EN 61000-4-3:1996 + A1:1998 + A2:2001

Eingesetzte Meßgeräte/ Test Equipment								
	R & S Messender/ Transmitter Kalmus 10 W HF Verstärker/ Amplifier Chase Log.Per. Antenne/ Antenna Chauvin Arnoux Fieldmeter MEB Richtkoppler/ Coppler SINPRO Stripline 15 cm	SMY 01 706F CBL 6111 CA 43 RK 100	SN. SN. SN. SN.	843574/006 8001-1 1764 1171555 BY 13046	2.2003 2.2003 2.2003 2.2003 2.2003			
DKD	DKD Kalibrierung/ DKD Verification							
	R & S Leistungsmeßkopf/ Power Head R & S Leistungsmesser/ Power Meter	NRV-Z51 NRVS	SN. SN.	825102/024 845443/006	2.2003 2.2003			


Traceability Standards Meßunsicherheit/ Calibration Uncertainty +- 1,25 dB

Die Kalibrierung ist rückführbar auf nationale Einheiten. The calibration is traceable to national normals.

Interne Kalibrierung des Messaufbaues/ Inhouse Verification of Test Setup

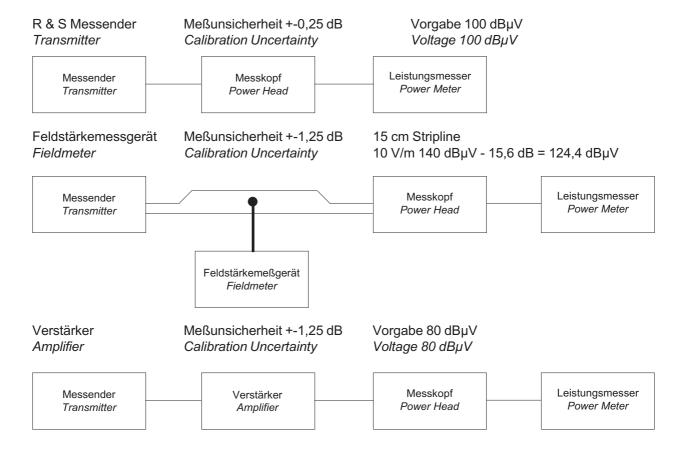




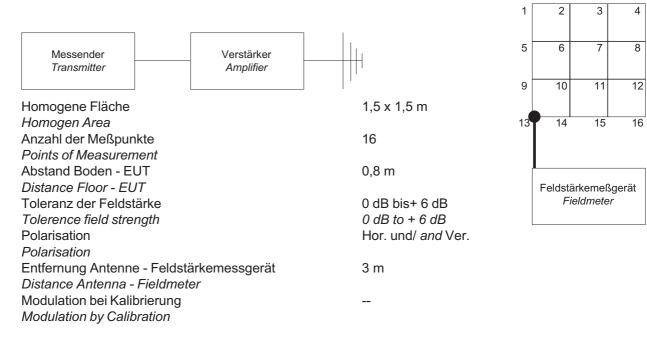

Messplatz 3/ Test Site 3 Absorberhalle/ Anechoic Chamber (Foam)

Testaufbau/ Test Setup




Prüfmerkmale/ Test Passed by Result

Feldstärke/ Field Strength 3 V/m Bewertungskriterium/ Performance Criteria A

Die Anordnung der Teile entspricht der späteren Installation. The order of the parts corresponds to the later installation.

Die Verkabelung erfolgt nach den Vorgaben des Kunden. The wiring is carried out according to the handicaps of the customer.



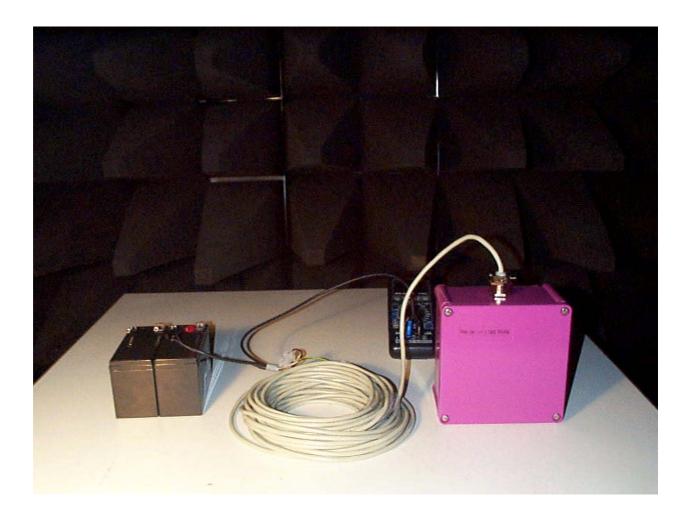

Bewertungskriterien für das Betriebsverhalten/ Performance Criteria in Accordance with Description

- A Bestimmungsgemäßes Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. Normal performance within the specification limits.
- B Zeitlich begrenzte Minderung der Funktion oder Funktionsausfall, die das Gerät selbst wieder herstellt. Temporary degradation or loss of function or performance which is self-recoverable
- C Zeitlich begrenzte Minderung der Funktion oder Funktionsausfall, die einen Eingriff der Bedienungsperson oder die Rücksetzung des Systems erfordern. *Temporary degradation or loss of function or performance which requires operator intervention or system reset.*
- D Minderung der Funktion oder Funktionsausfall, die nicht mehr hergestellt werden kann, da das Gerät, die Betriebssoftware zerstört wurden oder Daten verloren gingen. Degradation or loss of function which is not recoverable due to damage of equipment (components) or software, or loss of data.

Das Bewertungskriterium wird überwacht durch Beobachtung. *Performance criteria will be observed by operator.*

Gemessene Anschlüsse/ Measuring Ports

Gehäuse/ Enclosure



Prüfdurchführung/ Test operation - Betriebszustand/ Applicability In Betrieb/ In Use

Frequenzbereich 80 - 1000 MHz Frequency Range 800 - 960 MHz

Frequenzschritte 1 % je drei Sekunden/ per 3 sec.

Frequency step Vorgabe per Software/ Scaling by Software.

Abstand Antenne-EUT

Distance Antenna-EUT

3 m

Modulation 80 % AM 1kHz *Modulation*

Vertikale Antennenpolarisation/ Ver. polarisation

Prüfling EUT	Bewertungskriterium bzw. A bei 3 V/m Feldstärke by 3 V/m Field Strength	Ausfallzeit <i>Performance Criteria</i> or <i>Failure Time</i> bei 10 V/m Feldstärke by 10 V/m Field Strength
Frontansicht/ Frontside	А	A
rechte Seite/ Rightside	A	A
linke Seite/ Leftside	A	A
Rückansicht/ Backside	A	A

Horizontale Antennenpolarisation/ Hor. polarisation

Prüfling <i>EUT</i>	Bewertungskriterium bzw. Ausf bei 3 V/m Feldstärke by 3 V/m Field Strength	allzeit <i>Performance Criteria or Failure Time</i> bei 10 V/m Feldstärke by 10 V/m Field Strength
Frontansicht/ Frontside	А	A
rechte Seite/ Rightside	А	A
linke Seite/ Leftside	Α	A
Rückansicht/ Backside	A	A

Bemerkungen/ Remarks ---



Prüfung der Störfestigkeit gegen transiente Störsignale (BURST) Susceptibility Against ns-Pulses (BURST)

Test bestanden Test passed

Prüfverfahren/ Test Specification

DIN EN 61000-4-4, Ausgabe:2001-12, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-4: Prüf- und Messverfahren; Prüfung der Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst (IEC 61000-4-4:1995 + A1:2000); Deutsche Fassung EN 61000-4-4:1995 + A1:2001

Eingesetzte Meßgeräte/ Test Equipment		

Tektronix Oszilloskop/ OscilloscopeTDS 220SN. B 0131292.2003Tektronix Tastkopf/ Oscilloscope ProbeP 51002.2003

EM Test Kapazitive Koppelzange/Cable Clamp HFK SN. 0395-20 2.2003

DKD Kalibrierung/ DKD Verification

EM Test Burst Generator/ Test Generator EFT 500 SN. 250 2.2003

Traceability Standards Meßunsicherheit Spannung/ Calibration Uncertainty Voltage +- 3 %

Meßunsicherheit Zeit/ Calibration Uncertainty Time +- 0,01 %

Die Kalibrierung ist rückführbar auf nationale Einheiten. The calibration is traceable to national normals.

Interne Kalibrierung des Messaufbaues/ Inhouse Verification of Test Setup


Das Burstsignal wird mit einem 50 Ohm Widerstand abgeschlossen. *The burst signal source is terminated by a 50 ohms resistor.* Der Impuls wird am Oszilloskop betrachtet. *An oscilloscope displays the measured graph.*

Spitzenwert	260 V	5 kHz +- 20%	Burstperiode/ Period	300 ms	+- 20%
Peak voltages	500 V	5 kHz +- 20%	Burstdauer/ Burst Duration	15 ms	+- 20%
	1000 V	5 kHz +- 20%	Anstiegszeit/ Rise time	5 ns	+- 30%
	2000 V	5 kHz +- 20%	Impulsdauer/ Pulse Duration	50 ns	+- 30%
	4000 V	2.5 kHz +- 20%			


Prüfdurchführung/ Test Operation

Messplatz 2/ Test Site 2

Testaufbau/ Test Setup



Die Signalleitungen werden in die kapazitive Koppelzange gelegt und mit dem Prüfsignal beaufschlagt. Signalcable put into the capacitive coupling clamp connected to the burst signal.



Das Ziel des Testes ist die Störfestigkeit des EUT gegen Interferenzen zu ermitteln, die z.B. durch das Schalten von induktiven Lasten entstehen kann. The aim of the test is to determine the immunity of the EUT to interference which is transient due to cuts, such as cuts in the inductive charge, rebound contacts, etc.





Prüfmerkmale/ Test Passed by Result

AC/ DC Eingänge/ Power Port 1 kV, Signalleitung/ Signal Port 500 V Bewertungskriterium/ Performance Criteria B.

Bewertungskriterien für das Betriebsverhalten/ Performance Criteria in Accordance with Description

- A Bestimmungsgemäßes Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. Normal performance within the specification limits.
- B Zeitlich begrenzte Minderung der Funktion oder Funktionsausfall, die das Gerät selbst wieder herstellt. Temporary degradation or loss of function or performance which is self-recoverable
- C Zeitlich begrenzte Minderung der Funktion oder Funktionsausfall, die einen Eingriff der Bedienungsperson oder die Rücksetzung des Systems erfordern. *Temporary degradation or loss of function or performance which requires operator intervention or system reset.*
- D Minderung der Funktion oder Funktionsausfall, die nicht mehr hergestellt werden kann, da das Gerät, die Betriebssoftware zerstört wurden oder Daten verloren gingen. Degradation or loss of function which is not recoverable due to damage of equipment (components) or software, or loss of data.

Das Bewertungskriterium wird überwacht durch Beobachtung.

Performance criteria will be observed by operator.



Prüfdurchführung/ Test operation - Betriebszustand/ Applicability In Betrieb/ In Use

Dauer/ Time 1 Minute

Kapazitive Einkopplung mit Kondensator/ Capacitive Coupling with condensator

Gemessene Anschlüsse Measuring Ports	Bewerto +500V 5 kHz	ungskriter -500V 5 kHz	ium/ <i>Perfo</i> +1kV 5 kHz	ormance (-1kV 5 kHz	Criteria bzv +2kV 5 kHz	w. Ausfall: -2kV 5 kHz	zeit/ <i>Failur</i> +4kV 2,5kHz	e <i>Time</i> -4kV 2,5kHz
0 V	Α	А	Α	Α	А	Α	А	A
12 V	Α	А	Α	Α	Α	Α	Α	A
0 V, 12V	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	A

Kapazitive Einkopplung mit Koppelzange/ Capacitive Coupling with Clamp

Gemessene Anschlüsse	Bewertungskriterium/ Performance Criteria bzw. Ausfallzeit/ Failure Time							
Measuring Ports	+260V	- 260 V	+500V	-500V	+1kV	-1kV	+2kV	-2kV
	5 kHz	5 kHz	5 kHz	5 kHz	5 kHz	5 kHz	5kHz	5kHz
Anschlußleitung	А	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α

Bemerkungen/Remarks ---



Prüfung der Störfestigkeit gegen hochfrequente Einströmung Susceptibility Against Conducted Sinus Wave

Test bestanden Test passed

Prüfverfahren/ Test Specification


DIN EN 61000-4-6, Ausgabe:2001-12, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-6: Prüf- und Messverfahren; Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder (IEC 61000-4-6:1996 + A1:2000); Deutsche Fassung EN 61000-4-6:1996 + A1:2001

Eingesetzte Meßgeräte/ Test Equipment				Kal./Cal.
R & S Messender/ Transmitter ENI 100 W Verstärker/ Amplifier MEB Richtkoppler/ Coppler MEB EM Koppelstrecke/ Power Clamp R & S Leistungsmeßkopf/ Power Head	SMY 01 3100 LA RK 100 KEMZ-801 URV5-Z4	SN. SN. SN. SN.	843574/006 116 13046 12664 844380/055	2.2003 2.2003 2.2003 2.2003 2.2003
DKD Kalibrierung/ DKD Verification				
R & S Leistungsmeßkopf/ Power Head R & S Leistungsmesser/ Power Meter	NRV-Z51 NRVS	SN. SN.	825102/024 845443/006	2.2003 2.2003

Traceability Standards Meßunsicherheit/ Calibration Uncertainty +-1,25 dB

Die Kalibrierung ist rückführbar auf nationale Einheiten. The calibration is traceable to national normals.


Interne Kalibrierung des Messaufbaues/ Inhouse Verification of Test Setup

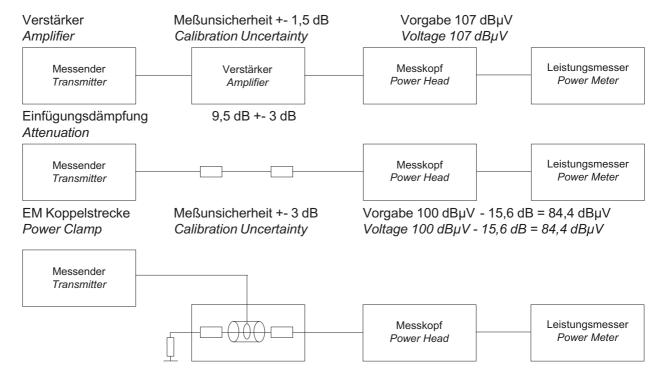

Prüfdurchführung/ Test Operation

Messplatz 2/ Test Site 2 Absorberhalle/ Anechoic Chamber (Foam)



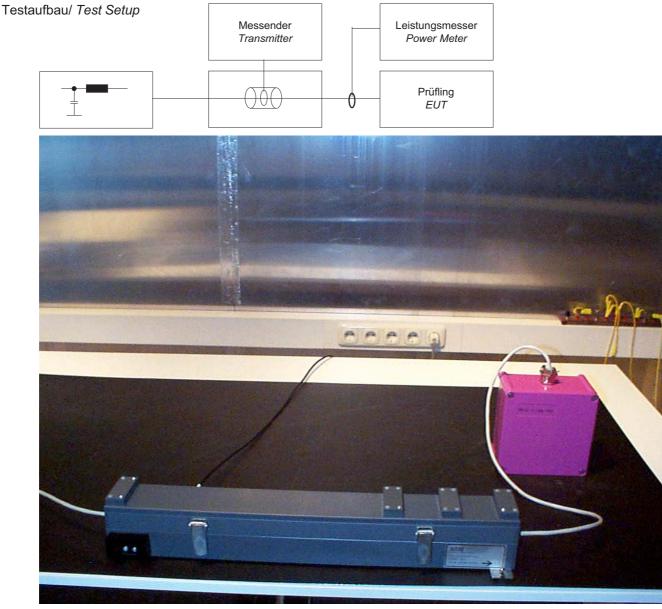

Prüfmerkmale/ Test Passed by Result

3 Vemk, Bewertungskriterium/ Performance Criteria A.

Bewertungskriterien für das Betriebsverhalten/ Performance Criteria in Accordance with Description

- A Bestimmungsgemäßes Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. Normal performance within the specification limits.
- B Zeitlich begrenzte Minderung der Funktion oder Funktionsausfall, die das Gerät selbst wieder herstellt. Temporary degradation or loss of function or performance which is self-recoverable
- C Zeitlich begrenzte Minderung der Funktion oder Funktionsausfall, die einen Eingriff der Bedienungsperson oder die Rücksetzung des Systems erfordern. *Temporary degradation or loss of function or performance which requires operator intervention or system reset.*
- D Minderung der Funktion oder Funktionsausfall, die nicht mehr hergestellt werden kann, da das Gerät, die Betriebssoftware zerstört wurden oder Daten verloren gingen. Degradation or loss of function which is not recoverable due to damage of equipment (components) or software, or loss of data.

Das Bewertungskriterium wird überwacht durch Beobachtung.

Performance criteria will be observed by operator.



Prüfdurchführung/ Test operation - Betriebszustand/ Applicability In Betrieb/ In Use

Frequenzbereich

150 kHz - 80 MHz

Frequency Range

Frequenzschritte 1% je drei Sekunden/per s.

Frequency step Vorgabe per Software/ Scaling by Software.

Modulation Modulation 80 % AM 1 kHz Sinus

Kopplung mit Coupling with Koppelzange

Clamp

Gemessene Anschlüsse

Measuring Ports

Bewertungskriterium/ Performance Criteria bzw. Ausfallzeit/ Failure Time

bei 3 Vemk Spannung

bei 10 Vemk Spannung

by 3 Vemk Voltage

by 10 Vemk Voltage

Anschlußleitung

Α

Α

Bemerkungen/Remarks



Messung der Funkstörspannung Measuring Conducted Voltage Emission

Test bestanden Test passed


Prüfverfahren/ Test Specification

DIN EN 55011, Ausgabe:2000-05 Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Hochfrequenzgeräte (ISM-Geräte) - Funkstörungen; Grenzwerte und Meßverfahren (IEC/CISPR 11:1997, modifiziert); Deutsche Fassung EN 55011:1998 Gruppe/ *Group 1* Interne HF Klasse/*Class* B Niederspannungsnetz

Einge	Eingesetzte Meßgeräte/ Test Equipment					
	R & S Messender/ <i>Transmitter</i> R & S Meßempfänger/ <i>Receiver</i> SINPRO Absorberhalle/ <i>Absorber Hall</i>	SMY 01 ESPC	SN. SN.	843574/006 846824/028	2.2003 2.2003	
	R & S 5-Leiter Netzwerk/ Artificial Mains Network (LISN)	ESH2-Z5	SN.	843285/005	2.2003	
DKD	Kalibrierung/ DKD Verification					
	R & S Leistungsmesser/ Power Meter R & S Leistungsmeßkopf/ Power Head	NRVS NRV-Z51	SN. SN.	845443/006 825102/024	2.2003 2.2003	

Traceability Standards Meßunsicherheit/ Calibration Uncertainty +-1,25 dB
Die Kalibrierung ist rückführbar auf nationale Einheiten. The calibration is traceable to national normals.

Interne Kalibrierung des Messaufbaues/ Inhouse Verification of Test Setup

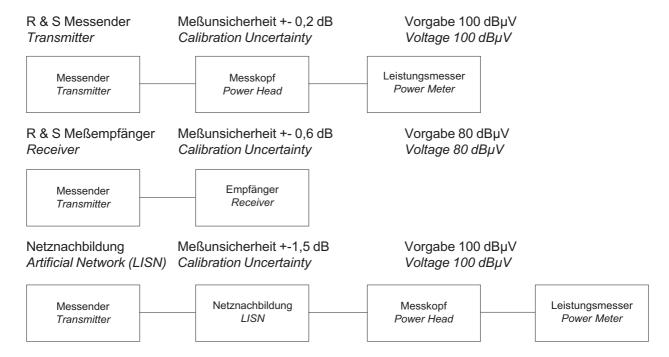



Messung des Fremdstörpegels min.6 dB. Measuring Voltage Without EUT.



Messung eines Spannungspegels 60 dBμV. Measuring Signal Voltage 60 dBμV.



Prüfdurchführung/ Test Operation

Messplatz 1/ Test Site 1
Absorberhalle/ Anechoic Chamber (Foam)

Der Prüfling wird an die Netznachbildung angeschlossen. The EUT is connected to the LISN. Der Spannungswert ergibt sich aus der Addition der Empfängerablesung in dB μ V und des Transducerfaktors in dB. The voltage value is calculated by adding the receiver reading in dB μ V to the transducer factor dB.

Testaufbau/ Test Setup



Prüfmerkmale/ Test Passed by Result

Der Prüfling muss die QP/ AV Grenzwerte unterschreiten. The EUT must not cross the QP/ AV border line.

Gemessene Anschlüsse/ Measuring Ports

DC Eingang/ DC Power Port





Prüfergebnis/ Test Results

Die Störspannungen werden zwischen den einzelnen Leiter einzeln gemessen. The measurement of the voltage against the earth of the different phases is carried out succesively.

Der Spitzenwert (blaue Linie) und der Mittelwert (grüne Linie) wird kontinuierlich in die Grafik eingetragen. *The peak (blue line) and the average (green line) value are recorded continuosly on the graph.* Werte mit einen Abstand kleiner 6 dB werden nachgemessen. *Values smaller 6 dB distance to border line will be checked.*

Die rot eingetragenen Kreuze sind die maximalen Werte der Nachmessung. *The crosses typed in red are the maximum results of the finalmeasuring.* Diese Werte sind auch in der Tabelle auf der Folgeseite dargestellt. *These results are represented also in the table on the continuation page.* Nur der Maximalwert der verschiedenen Messungen wird eingetragen. *Only the maximum of all the values is displayed.*

Die maximalen Werte (rote Kreuze) überschreiten die Grenzwertlinie nicht. *The maximum results (red crosses) don't exceed the limiting value line.*



SCHWILLE ELEKTRONIK GMBH EMV LABOR MESSUNG DER FUNKSTÖRSPANNUNG AC/DC

EUT: SBL 1
Manuf: Seika GmbH

Op Cond:

Operator: Manfred Schiedrich

Test Spec: Messung auf 12 V DC 0 V Leitung

Comment:

File: 2506ss1.dat : New Measurement

Scan Settings (1 Range)

Receiver Settings Frequencies IF BW Start M-Time OpRge Stop Step Detector Atten 150kHz 30MHz 5kHz 10kHz PK+AV 20msec Auto 60dB


 Transducer
 No.
 Start
 Stop
 Name

 12
 9kHz
 30MHz
 ESH3_Z5+

Prescan Measurement: X PK / + AV

Meas Time: see scan settings

Subranges: 25 Acc Margin: 6 dB

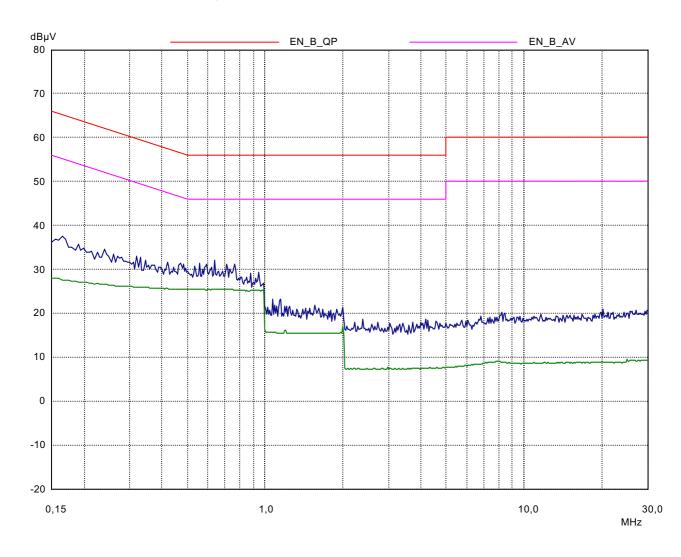



SCHWILLE ELEKTRONIK GMBH EMV LABOR MESSUNG DER FUNKSTÖRSPANNUNG AC/DC

EUT: SBL 1
Manuf: Seika GmbH

Op Cond:

Operator: Manfred Schiedrich

Test Spec: Messung auf 12 V DC 0 V Leitung

Comment:

File: 2506ss1.dat : New Measurement

Scan Settings (1 Range)

Receiver Settings Frequencies IF BW Start Stop Step Detector M-Time Atten OpRge 150kHz 30MHz 5kHz 10kHz PK+AV 20msec Auto 60dB

Transducer No. Start Stop Name

12 9kHz 30MHz ESH3_Z5+

Prescan Measurement: X PK / + AV

Meas Time: see scan settings

Subranges: 25 Acc Margin: 6 dB

Peak Search Results:

Frequency PK Level PK Limit PK Delta Phase PE MHz dB μ V dB μ V dB - -

No results

Frequency AV Level AV Limit AV Delta Phase PE MHz dB μ V dB μ V dB - -

No results

^{*} limit exceeded



SCHWILLE ELEKTRONIK GMBH EMV LABOR MESSUNG DER FUNKSTÖRSPANNUNG AC/DC

EUT: SBL 1
Manuf: Seika GmbH

Op Cond:

Operator: Manfred Schiedrich

Test Spec: Messung auf 12 V DC Leitung

Comment:

File: 2506ss2.dat : New Measurement

Scan Settings (1 Range)

Receiver Settings Frequencies IF BW Start M-Time OpRge Stop Step Detector Atten 150kHz 30MHz 5kHz 10kHz PK+AV 20msec Auto 60dB


 Transducer
 No.
 Start
 Stop
 Name

 12
 9kHz
 30MHz
 ESH3_Z5+

Prescan Measurement: X PK / + AV

Meas Time: see scan settings

Subranges: 25 Acc Margin: 6 dB

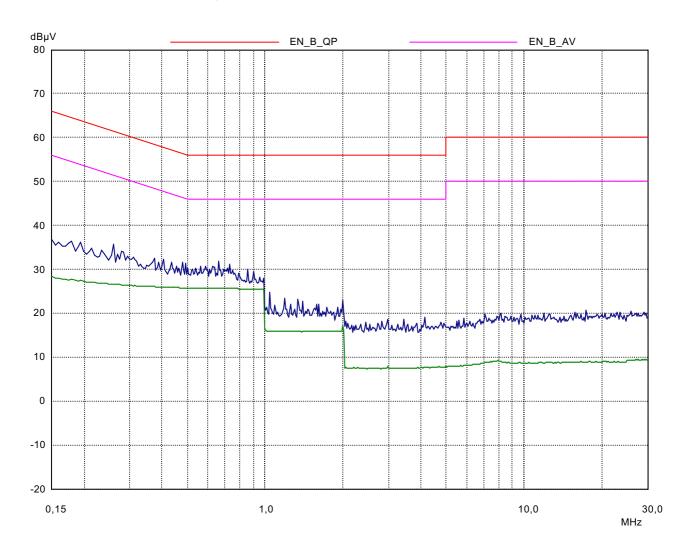



SCHWILLE ELEKTRONIK GMBH EMV LABOR MESSUNG DER FUNKSTÖRSPANNUNG AC/DC

EUT: SBL 1
Manuf: Seika GmbH

Op Cond:

Operator: Manfred Schiedrich

Test Spec: Messung auf 12 V DC Leitung

Comment:

File: 2506ss2.dat : New Measurement

Scan Settings (1 Range)

Receiver Settings Frequencies IF BW Start Stop Step Detector M-Time Atten OpRge 150kHz 30MHz 5kHz 10kHz PK+AV 20msec Auto 60dB

Transducer No. Start Stop Name

12 9kHz 30MHz ESH3_Z5+

Prescan Measurement: X PK / + AV

Meas Time: see scan settings

Subranges: 25 Acc Margin: 6 dB

Peak Search Results:

Frequency PK Level PK Limit PK Delta Phase PE MHz dB μ V dB μ V dB - -

No results

Frequency AV Level AV Limit AV Delta Phase PE MHz dB μ V dB μ V dB - -

No results

^{*} limit exceeded



Messung der elektrischen Funkstörfeldstärke Measuring Radiated E-Field Emission

Test bestanden Test passed

Prüfverfahren/ Test Specification


DIN EN 55011, Ausgabe: 2000-05 Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Hochfrequenzgeräte (ISM-Geräte) - Funkstörungen; Grenzwerte und Meßverfahren (IEC/CISPR 11:1997, modifiziert); Deutsche Fassung EN 55011:1998 Gruppe/ Group 1 Interne HF Klasse/Class B Niederspannungsnetz

Eingesetzte Meßgeräte/ Test Equipment					
R & S Messender/ <i>Transmitter</i> Schwarzbeck Halbwellen Dipol/ <i>Half-Wave Dipole</i> Schwarzbeck Halbwellen Dipol/ <i>Half-Wave Dipole</i>	SMY 01 VHA 9103 UHA 9105	SN. SN. SN.	843574/006 9014 9015	2.2003 2.2003 2.2003	
R & S Meßempfänger/ <i>Receiver</i> SINPRO Absorberhalle/ <i>Absorber Hall</i> 10 m Freifeld/ <i>Field</i>	ESPC	SN.	846824/028	2.2003	
R & S Vorverstärker/ Amplifier	ESV-Z3	SN.	847944/002	2.2003	
Chase Log.Per. Antenne/ Antenna	CBL 6111	SN.	1764	2.2003	
DKD Kalibrierung/ DKD Verification					
R & S Leistungsmesser/ Power Meter R & S Leistungsmeßkopf/ Power Head	NRVS NRV-Z51	SN. SN.	845443/006 825102/024	2.2003 2.2003	

Traceability Standards Meßunsicherheit/ Calibration Uncertainty +-1,25 dB

Die Kalibrierung ist rückführbar auf nationale Einheiten. The calibration is traceable to national normals.

Interne Kalibrierung des Messaufbaues/ Inhouse Verification of Test Setup

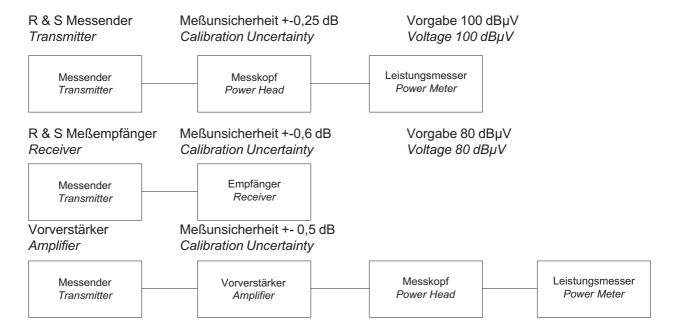



Meßplatzdämpfung Meßunsicherheit +- 4 dB Absorberhall Attentuation Calibration Uncertainty



Ein abgestimmter Halbwellendipol ist die Bezugsbasis für die Feldstärkemessung. A tuned Half-wave Dipole is the reference antenna for field-strength measurement.

Log-Per. Antenne
Log.Per. Antenna

Meßunsicherheit +- 0,75 dB
Calibration Uncertainty

Messender
Transmitter

Empfänger
Receiver

Kalibrierung des Messaufbaues/ Verification of Test Setup

Messung des Fremdstörpegels > 6 dB. Measuring Voltage Without EUT.



Prüfdurchführung/ Test Operation

Messplatz 3/ Test Site 3
Absorberhalle/ Anechoic Chamber (Foam)

Die Feldstärke ergibt sich aus der Addition der Empfängerablesung in dBµV und des Antennenfaktors in dB (1/m). The field-strength is calculated by adding the receiver reading in dBµV to the antenna factor dB (1/m).


Testaufbau/ Test Setup

Prüfling EUT


Freifeld/ Schirmkabine Abstand 10 m

Measurement Field/ Shielded Room Distance

Azimut
0° - 360°

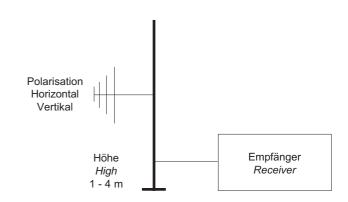



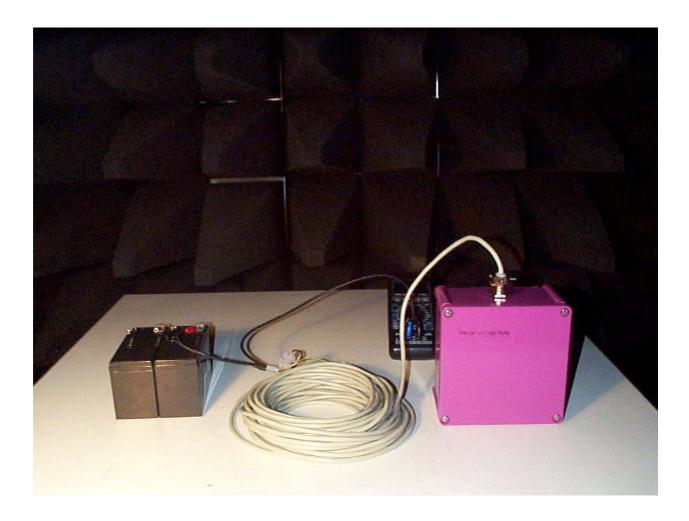

Prüfmerkmale/ Test Passed by Result

Der Prüfling muss die QP Grenzwerte unterschreiten. The EUT must not cross the QP border line.

Gemessene Anschlüsse/ Measuring Ports

Gehäuse/ Enclosure

Prüfergebnis/ Test Results

Die hellblaue Linie zeigt den Wert ohne Testgerät.(Grundrauschen) *The ice blue line shows the value without test piece of equipment.* Aussendungsmesswerte, welche ursächlich durch Umgebungsstörungen entstanden sind, werden später gelöscht. *Emission values causality from environment are deleted.*

Die dunkelblaue Linie ist eine Peak Vormessung mit verkürzter Messzeit. The deep blue line is Peak premeasuring with an abbreviated measurement time. Die rot eingetragenen Kreuze sind die maximalen Werte der QP Nachmessung. The crosses typed in red are the maximum results of the QP finalmeasuring. Diese Werte sind auch in der Tabelle auf der Folgeseite dargestellt. These results are represented also in the table on the continuation page.

Die maximalen Werte (rote Kreuze) überschreiten die Grenzwertlinie nicht. *The maximum results (red crosses) don't exceed the limiting value line.*



SCHWILLE ELEKTRONIK GMBH EMV LABOR MESSUNG DER ELEKTRISCHEN FUNKSTÖRFELDSTÄRKE

EUT: SBL1
Manuf: Seika GmbH

Op Cond:

Operator: Manfred Schiedrich
Test Spec: Antenne senkrecht

Comment:

File: 2506ef1.dat : New Measurement

Scan Settings (1 Range) Frequencies Receiver Settings IF BW Start M-Time OpRge Stop Step Detector Atten 30MHz 1GHz 60kHz 120kHz PK 2msec 0 dB 60dB


 Transducer
 No.
 Start
 Stop
 Name

 22
 20MHz
 1GHz
 CBL6111+

Prescan Measurement: X PK

Meas Time: see scan settings

Subranges: 25 Acc Margin: 6 dB

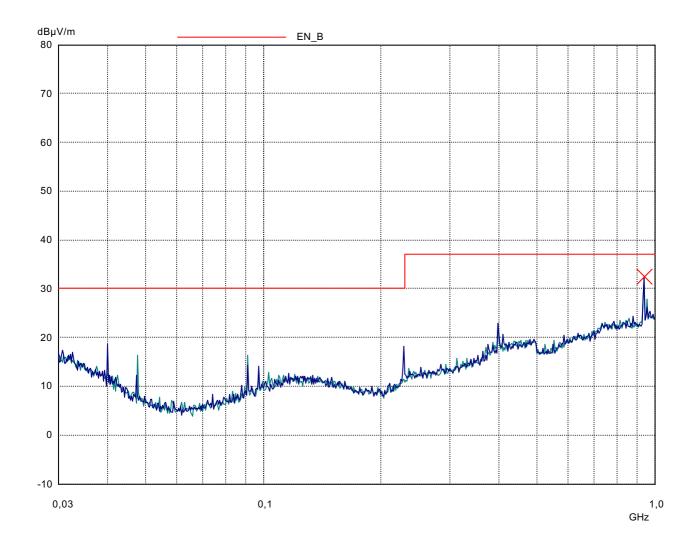



SCHWILLE ELEKTRONIK GMBH EMV LABOR MESSUNG DER ELEKTRISCHEN FUNKSTÖRFELDSTÄRKE

EUT: Seika GmbH Manuf:

Op Cond:

Operator: Manfred Schiedrich Test Spec: Antenne senkrecht

Comment:

File: 2506ef1.dat : New Measurement

Scan Settings (1 Range)

Receiver Settings Frequencies IF BW Start M-Time Stop Step Detector Atten OpRge 30MHz 1GHz 60kHz 120kHz PK 2msec 0 dB 60dB

Transducer No. Start Stop Name 22

20MHz 1GHz CBL6111+

Prescan Measurement: X PK

> Meas Time: see scan settings

Subranges: 25 6 dB Acc Margin:

Peak Search Results:

PK Limit PK Delta Ref. Offset PK Level Frequency GHz dBµV/m dBµV/m dB dB 0,94248 32,39 37.00 4.61 -1,95



SCHWILLE ELEKTRONIK GMBH EMV LABOR MESSUNG DER ELEKTRISCHEN FUNKSTÖRFELDSTÄRKE

EUT: SBL1
Manuf: Seika GmbH

Op Cond:

Operator: Manfred Schiedrich
Test Spec: Antenne waagerecht

Comment:

File: 2506ef2.dat : New Measurement

Scan Settings (1 Range) Frequencies Receiver Settings IF BW Start M-Time OpRge Stop Step Detector Atten 30MHz 1GHz 60kHz 120kHz PK 2msec 0 dB 60dB


 Transducer
 No.
 Start
 Stop
 Name

 22
 20MHz
 1GHz
 CBL6111+

Prescan Measurement: X PK

Meas Time: see scan settings

Subranges: 25 Acc Margin: 6 dB

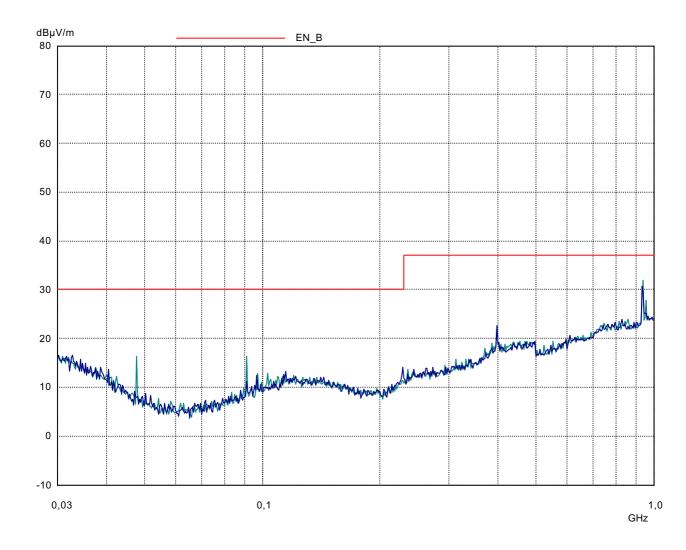



SCHWILLE ELEKTRONIK GMBH EMV LABOR MESSUNG DER ELEKTRISCHEN FUNKSTÖRFELDSTÄRKE

EUT: SBL1
Manuf: Seika GmbH

Op Cond:

Operator: Manfred Schiedrich
Test Spec: Antenne waagerecht

Comment:

File: 2506ef2.dat : New Measurement

Scan Settings (1 Range)

Receiver Settings Frequencies IF BW Start M-Time Stop Step Detector Atten OpRge 30MHz 1GHz 60kHz 120kHz PK 2msec 0 dB 60dB

Transducer No. Start Stop Name

22 20MHz 1GHz CBL6111+

Prescan Measurement: X PK

Meas Time: see scan settings

Subranges: 25 Acc Margin: 6 dB

Peak Search Results:

Frequency PK Level PK Limit PK Delta Ref. Offset GHz dB μ V/m dB μ V/m dB dB

No results

^{*} limit exceeded